

Phonak

Target 7.2

Guide d'utilisation pour Target/ALPS



Phonak Target/ALPS vous permet de synchroniser directement des données depuis Phonak Target vers ALPS. Ce procédé évite la double saisie des informations et facilite la gestion de l'ensemble des souscriptions et réglages Lyric.

Pour utiliser cette synchronisation, l'ordinateur sur lequel vous effectuez vos réglages doit disposer d'une connexion internet.

Après l'installation de Phonak Target, les nouvelles fonctionnalités seront activées automatiquement. Pour chaque réglage Lyric, vous serez automatiquement connecté à ALPS. Un assistant vous guidera à travers toutes les étapes nécessaires.

Plus d'informations sont également disponibles dans [\[Aide Internet\]](#).


Contenu

Créer un nouveau patient dans Phonak Target/ALPS.....	2
Accéder aux réglages et aux données ALPS d'un patient.....	6
Remplacer un appareil (incl. l'observation du conduit auditif).....	7
Cas touriste: Insertion d'un nouvel appareil dans votre centre.....	10
Cas touriste: Un de vos clients a renouvelé son appareillage dans un centre agréé Lyric.....	11
Renouvellement automatique de la souscription.....	12
Annuler une souscription active.....	13
Synchroniser des modifications effectuées hors connexion.....	14
Trouver les raccourcis vers ALPS.....	16
Activer l'historique détaillé pour l'assistance.....	19
Information et description des symboles et de la configuration requise du système.....	19

Créer un nouveau patient dans Phonak Target/ALPS

Pour créer un nouveau patient dans Phonak Target et insérer un appareil Lyric de votre stock :

1. Allez dans [Appareils] puis [Aides auditives] pour sélectionner un appareil Lyric
2. Allez dans [Configuration Lyric] et cliquez sur [Sélectionner un appareil] pour ouvrir le portail de connexion Phonak Target/ALPS.

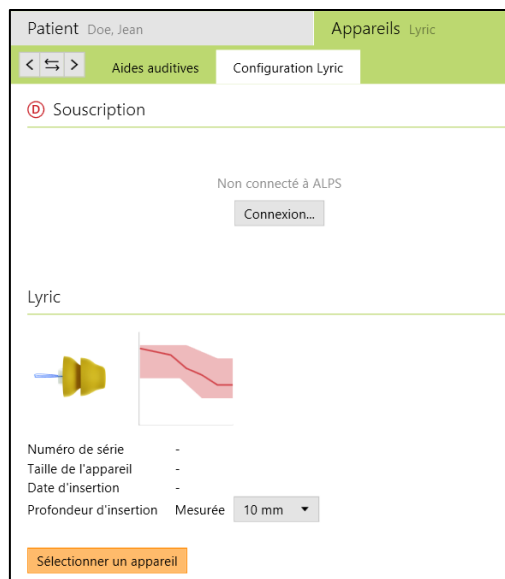

La couleur du bouton ALPS indique le statut de connexion:


- Vert - connecté
- Noir - déconnecté




Connectez-vous à votre compte Lyric grâce à vos identifiants.

Nous recommandons de cocher la case [Connexion automatique]. Ainsi, vous serez toujours connectés à votre compte sans avoir besoin d'entrer à nouveau vos identifiants et/ou de confirmer la connexion, offrant ainsi un gain de temps appréciable.


En cas d'oubli de votre mot de passe, vous avez la possibilité de cliquer sur le lien [Oublié] puis de le changer sur www.phonakpro.com directement.

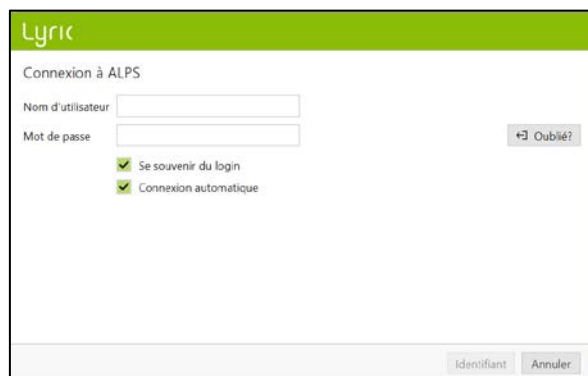

Vous êtes maintenant invité à sélectionner [Ajouter le patient actuel à votre compte ALPS]. Les identifiants de votre compte sont visibles sur l'écran, ce qui est pratique pour les audioprothésistes travaillant avec plusieurs comptes.

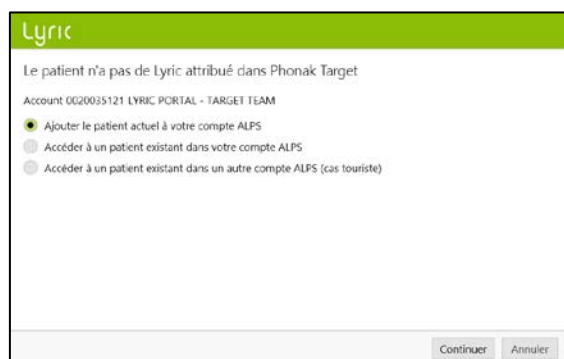

Si vous souhaitez travailler depuis un autre compte ALPS, choisissez la fonction [Changer de login...] sous le bouton ALPS et connectez-vous avec l'identifiant souhaité.



Vous avez la possibilité de contrôler et de corriger les données du client, telles que son prénom, nom, date de naissance et genre, enregistrés dans Phonak Target.

Les informations complémentaires (date de naissance et genre) sont facultatives. Si vous ne souhaitez pas transmettre ces données, décochez la ligne [Fournir des renseignements additionnels].

Il vous est ensuite demandé de confirmer que le client accepte que ses données soient transférées à Sonova à des fins de traitement. Si la case n'est pas cochée, le réglage ne peut pas continuer.

Sélectionnez le modèle Lyric voulu ainsi que sa taille et choisissez l'appareil que vous souhaitez utiliser. Privilégiez l'appareil avec la date d'expiration la plus proche.

Veillez noter que les appareils dont la date d'expiration est dépassée ne sont plus utilisables. Utilisez le [Retour d'appareils] dans ALPS, sélectionnez le numéro de série et le motif d'expiration et envoyez le à Phonak.

Sélectionnez la profondeur d'insertion mesurée.

Sélectionnez la durée de souscription choisie pour votre patient.

Assurez-vous de choisir l'option si votre client désire porter Lyric pour traiter les acouphènes.

The screenshot shows the 'Saisir le données patient' form. It includes input fields for 'Prénom' and 'Nom', a date field for 'Date de naissance' (01.01.1948), and a dropdown for 'Genre'. There is a checkbox for 'Fournir des renseignements additionnels' which is checked. At the bottom, there is a confirmation checkbox: 'Je confirme par la présente que j'ai pleinement informé mon client que ses données personnelles seront transférées au fabricant de l'aide auditive à des fins de traitement. Mon client a consenti à un tel transfert.' Below this are buttons for 'Créer un identifiant Lyric' and 'Annuler'.

The screenshot shows the 'Sélectionner un appareil Lyric dans votre stock dépôt' screen. It features a search bar for 'N° de série' and a 'Date d'insertion' field (04.08.2014). Below is a table with columns: 'N° de série', 'Modèle', 'Lyric3', 'Taille de la corolle', 'Tout', and 'Mis en place...'. The table lists several devices with serial numbers like 1406NY236 and 1406NY235, all with 'Lyric3' models and 'XS' sizes. At the bottom right, there are 'Sélectionner' and 'Annuler' buttons.


The screenshot shows the 'Sélectionnez la profondeur d'insertion mesurée' screen. It has a dropdown menu for 'Insertion initiale d'un appareil dans cette oreille.' with options from 3 mm to 15 mm. A mouse cursor is pointing at the 6 mm option. At the bottom right, there are 'Continuer' and 'Annuler' buttons.

The screenshot shows the 'Sélectionner les données de la souscription' screen. It includes dropdowns for 'Durée de la souscription' (Souscription d'un an) and 'Modalité de paiement' (Paiement annuel anticipé). There is a date field for 'Date de début' (04.05.2020) and a checked checkbox for 'Lyric est utilisé pour la prise en charge des acouphènes'. At the bottom right, there are 'Continuer' and 'Annuler' buttons.


Phonak Target confirme la sélection de l'appareil. Vous pouvez visualiser des [Informations supplémentaires] sur la souscription ou [Fermer] la fenêtre. Dans le cas d'une adaptation binaurale, vous êtes invité à [Passer à l'autre côté], ce qui vous permet de choisir directement un autre appareil de votre stock.




Sous la date de début et la date de fin de souscription, vous trouverez la date de fin de l'essai ainsi que le nombre d'appareils restants. Il est maintenant possible de prolonger l'essai de 10 jours supplémentaires. La nouvelle date de fin d'essai sera alors visible dans Target/ALPS.

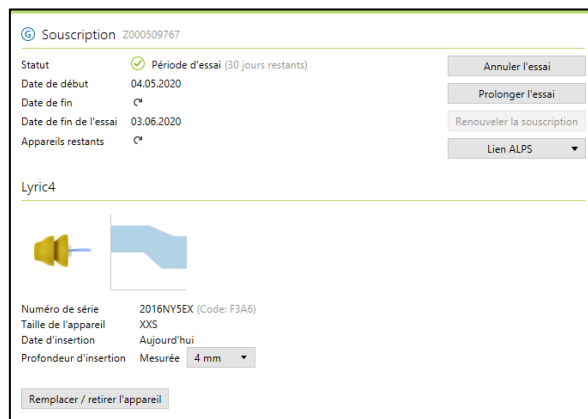

Si vous avez entré un faux numéro de série par erreur, vous pouvez le remettre dans votre stock en cliquant sur « Retourner au stock ».




Vous avez la possibilité d'afficher le Gain (oreille réelle et coupleur 0.4cc) ou le Niveau de sortie (SPL oreille réelle et le coupleur 0.4cc) lors du réglage des appareils Lyric. Cliquez [Sortie] ou [Gain] dans le menu pour sélectionner l'affichage de la courbe désirée. Lors de la sélection de l'affichage du niveau de sortie, vous pouvez également choisir d'afficher ou de masquer le seuil d'audition et l'UCL.




Si la profondeur d'insertion atteinte diffère de celle mesurée, une profondeur d'insertion mesurée et une profondeur d'insertion atteinte peuvent être saisies dans l'onglet [Appareillage]. Un message d'avertissement s'affichera si la profondeur d'insertion atteinte est supérieure à celle mesurée.




Sélectionnez [Enregistrer dans la base de données] pour synchroniser les réglages dans ALPS à la fin de la session.

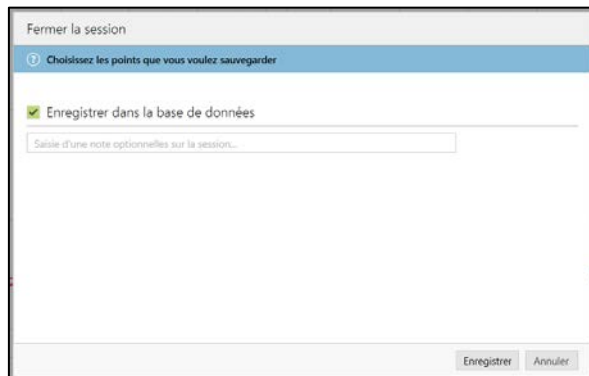


Si vous désirez écrire plus de notes dans le dossier patient, une nouvelle section de notes est disponible.



Une nouvelle note pour être ajoutée. Vous pouvez également choisir «Note visible (au prochain rendez-vous)» pour que cette note apparaisse lors du prochain rendez-vous.

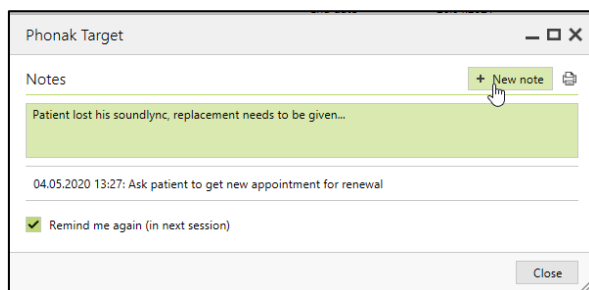

Toutes les notes sont visible sous [Client, notes].



Les rapports suivants peuvent être imprimés à partir du menu [Fichier], [Imprimer les rapports...], puis [Professionnel] :

- Rapport d'appareillage
- Fiche technique

[Patient]:

- Instructions de l'aide auditive
- Conseils et stratégies de communication
- Journal d'observations
- Guide sur la perte



Accéder aux réglages et aux données ALPS d'un patient

Si le client existe dans ALPS mais pas dans Target (ou dans le cas d'un premier réglage dans un laboratoire secondaire), choisissez [Accéder à un client existant dans votre compte ALPS].

Après avoir créé un patient dans Noah, les données seront transférées dans Phonak Target. Continuez jusqu'à atteindre l'écran où vous êtes invité à ajouter ou à accéder à un patient existant.

Saisissez l'identifiant Lyric de votre patient ainsi que son nom et prénom.

Pour accéder à l'identifiant Lyric ID de votre patient, vous pouvez vous connecter au portail ALPS ou l'obtenir à partir de la carte d'identification Lyric de votre patient.

L'identifiant Lyric ne vous est demandé que lors de la première connexion à partir de Target. Lors de l'ouverture d'une session, vous serez automatiquement connecté aux données ALPS.

Si le patient a été identifié par ALPS, l'écran affichera les données actualisées.

Lyric

Le patient actuel n'a pas d'identifiant Lyric dans Phonak Target. Comment voulez-vous procéder?

- Ajouter le client actuel à votre compte ALPS
- Accéder à un client existant dans votre compte ALPS
- Accéder à un client existant dans un autre compte ALPS (cas touriste)

Continuer Annuler

Lyric

Patient Lyric

Prénom: John

Nom: Doe

Identifiant Lyric: P000087951

Date de naissance: 01.02.1949

Sexe: Masculin

Chercher

Inclure la date de naissance et le sexe

Continuer Annuler

Lyric

Informations sur les souscriptions du patient

Prénom: John
Nom: Doe
Identifiant Lyric: P000087951

Information	Droit	Gauche
Souscription	En essai (30 jours restant)	En essai (30 jours restant)
Date de début	04.08.2014	04.08.2014
Date de fin	03.08.2015	03.08.2015
Appareils restants	6	6
Périphérique	Lyric3	Lyric3
Numéro de série	1406NY24G	1406NY237

Continuer Annuler

Remplacer un appareil (incl. l'observation du conduit auditif)

Pour remplacer un appareil Lyric, connectez-vous à Phonak Target, sélectionnez [Appareils], [Configuration Lyric] et cliquez sur [Remplacer / retirer l'appareil].

Sélectionnez si l'aide auditive a été retirée par l'audioprothésiste ou par le patient et précisez la date de retrait si elle diffère de la date d'aujourd'hui. Sélectionnez la raison du retrait, raisons qui sont groupées selon quatre catégories (Inconfort, Relatif à l'appareil, Relatif à l'appareillage, Retrait anticipé et Souscription annulée).

Le survol d'une catégorie fait apparaître une info-bulle avec plus de détails pour vous aider à choisir correctement la raison du retrait.

Patient: Doe, Jean P000168650 Appareils: Lyric (1,1)

Aides auditives Configuration Lyric

Souscription

Statut: En essai (30 jours restants)

Date de début: 22.11.2017

Date de fin: [C]

Date de fin de l'essai: 22.12.2017

Date de facturation: [C]

Appareils restants: [C]

Annuler l'essai

Renouveler la souscription

Lien ALPS

Lyric3

Numéro de série: 1736NYLUH (Code: E376)

Taille de l'appareil: L

Date d'insertion: Aujourd'hui

Profondeur d'insertion: Mesurée 9 mm

Remplacer / retirer l'appareil

Lyric

Retirer l'appareil Lyric

Numéro de série: 1849NY3G3

Retiré par: Audioprothésiste Patient lui-même

Date du retrait: Aujourd'hui Auparavant

Raison du retrait: --sélectionner--

- Inconfort
- Relatif à l'appareil
- Relatif à l'appareillage
- Retrait anticipé
- Cancelled subscription

Enlever Annuler

Lyric

Retirer l'appareil Lyric

Numéro de série: 1849NY3G3

Retiré par: Audioprothésiste Patient lui-même

Date du retrait: Aujourd'hui Auparavant

Raison du retrait: --sélectionner--

- Inconfort
- Relatif à l'appareil
- Relatif à l'appareillage
- Retrait anticipé
- Cancelled subscription

Relatif à l'appareil tooltip:

- L'appareil est devenu faible
- Pas de réponse / réponse intermittente au son
- Artifact sonore
- Cyclage de l'appareil / Remplacement inadéquat
- Son statique ou autres sons anormaux

Enlever Annuler

Phonak Target vous demandera alors de décrire l'état du conduit auditif observé : [OK pour réinsertion immédiate], [OK pour réinsertion après repos] ou [Avis médical nécessaire]. Si vous sélectionnez [OK pour réinsertion immédiate], l'échange de l'appareil peut se faire immédiatement. Si le conduit auditif est irrité et nécessite du repos avant réinsertion ou même un avis médical, le système vous alertera*. Les commentaires concernant la raison du retrait et l'observation du conduit auditif sont tous deux facultatifs.

Dans le cas [Avis médical nécessaire], des détails supplémentaires à propos de l'état du conduit auditif seront demandés.

Si l'autre appareil doit aussi être retiré, cliquez sur [Passer à l'autre côté]. Certaines raisons (retrait planifié, appareil proche de sa fin de vie et retrait anticipé par l'audioprothésiste) seront partagées par défaut sur l'autre côté. Elles seront néanmoins modifiables si les 2 appareils ne sont pas retirés pour les mêmes raisons.

* Si vous avez choisi [OK pour réinsertion après repos] ou [Avis médical nécessaire], Phonak Target vous informera sur la page d'accueil du logiciel.

Avant de valider l'échange de l'appareil, il est obligatoire de confirmer que le conduit auditif est [OK pour une réinsertion immédiate].

The screenshot shows the 'Retirer l'appareil Lyric' (Remove Lyric device) screen. It includes the following fields and options:

- Numéro de série: 1736NYLUH
- Retiré par: Audioprothésiste Patient lui-même
- Date du retrait: Aujourd'hui Auparavant
- Raison du retrait: Inconfort (dropdown menu)
- Détails supplémentaires (optionnel): (text input field)
- Observation du conduit auditif: OK pour réinsertion immédiate (dropdown menu)
- Observation supplémentaire du conduit auditif (optionnel): (text input field)

Buttons: Enlever, Annuler

Après avoir confirmé que l'oreille est OK pour une réinsertion immédiate, choisissez un nouvel appareil Lyric.

The screenshot shows the 'Sélectionner un appareil Lyric dans votre stock dépôt' (Select a Lyric device from your stock) screen. It includes the following elements:

- Taille de corolle de l'appareil: XS
- Recherche: N° de série
- Date d'insertion: 04.08.2014
- Tableau des appareils:

N° de série	Modèle	Lyric3	Taille de la corolle	XS	Mis en place...
1406NY24E	Lyric3		XS		
1406NY23X	Lyric3		XS		
1406NY23R	Lyric3		XS		
1406NY24H	Lyric3		XS		
1406NY24M	Lyric3		XS		
1406NY24K	Lyric3		XS		
1406NY24J	Lyric3		XS		
1406NY233	Lyric3		XS		
1406NY232	Lyric3		XS		

Buttons: Sélectionner, Annuler

Les commentaires que vous aurez éventuellement saisis seront enregistrés dans l'onglet [Patient] puis [Détails] rubrique [Notes].

The screenshot shows the 'Appareillage' (Hearing aid) screen with the 'Notes' section. It includes the following elements:

- Notes section header
- Input field: Saisir une nouvelle note de session...
- Log of notes:

- 04.08.2014 15:26: ECO Droit: OK pour réinsertion immédiate.
- 04.08.2014 15:23: ECO Droit: OK pour réinsertion après repos.
Observation du conduit auditif après retrait de l'appareil.
Le conduit auditif est légèrement irrité.

Veuillez noter que si l'appareil est porté depuis plus de 30 jours, le [Remplacement rapide] est activé et affiche les valeurs par défaut:

- L'appareil est retiré par l'audioprothésiste
- L'appareil est retiré aujourd'hui
- Le retrait est un retrait planifié
- Le conduit auditif est «correct pour une pose immédiate»


Cliquez sur [Supprimer], puis choisissez un nouvel appareil en conséquence.
Si les critères ne correspondent pas à la valeur par défaut, modifiez-les et continuez.

Cas touriste: Insertion d'un nouvel appareil dans votre centre


Dans le cas où vous souhaitez insérer Lyric à un patient initialement appareillé par un autre partenaire agréé Lyric, vous devez avoir accès à ses données d'appareillage (autre compte ALPS). Pour cela, vous avez besoin de l'identifiant Lyric du client.

Pour commencer, procédez comme pour un nouveau client, jusqu'à ce que Target vous demande d'identifier le client. Sélectionnez [Accéder à un client existant dans un autre compte ALPS (cas touriste)].

Saisissez l'identifiant Lyric du patient, et vérifiez que le nom s'affiche correctement comme indiqué sur la carte d'identification Lyric (en respectant majuscule, minuscule et espace). Procédez au remplacement de l'appareil et, si nécessaire, adaptez les paramètres d'appareillage.



The screenshot shows the Lyric application interface. At the top, there is a green header with the word "Lyric". Below the header, the text reads: "Le patient actuel n'a pas d'identifiant Lyric dans Phonak Target. Comment voulez-vous procéder?". There are three radio button options: "Ajouter le client actuel à votre compte ALPS", "Accéder à un client existant dans votre compte ALPS", and "Accéder à un client existant dans un autre compte ALPS (cas touriste)". The third option is selected. Below the options, there is a small information icon and the text: "Les données de la session dans Phonak Target vont être mises à jour d'après ALPS.". At the bottom right, there are two buttons: "Continuer" and "Annuler".



The screenshot shows the Lyric application interface for patient identification. At the top, there is a green header with the word "Lyric". Below the header, the text reads: "Patient Lyric". There are four input fields: "Prénom:" with the value "John", "Nom:" with the value "Doe", "Identifiant Lyric:" with the value "P00008795", and "Date de naissance:" and "Sexe:" both with a dash "-" as a value. At the bottom right, there are two buttons: "Continuer" and "Annuler".

Cas touriste: Un de vos clients a renouvelé son appareillage dans un centre agréé Lyric

Lorsque vous saisissez le nom du client, un message d'information vous indique un conflit de données entre ALPS (Adaptation d'un autre centre agréé Lyric) et Phonak Target (votre session d'appareillage). Le message indique que le numéro de série a été modifié.

Cliquez sur [Continuer] pour mettre à jour le système avec le dernier numéro de série adapté.

The screenshot shows a Lyric interface with a green header. Below the header is an orange bar with the title "Conflit de données entre ALPS et Phonak Target". The main content area displays the following information:

Prénom: John
Nom: Doe
Identifiant Lyric: P000087951

Les données de l'appareil dans ALPS et dans Phonak Target ne correspondent pas:

Information	Droit	Gauche
Souscription	En essai (30 jours restant)	En essai (30 jours restant)
ALPS	1349NV427	Pas de N° de série
Phonak Target	1406NY24E	1406NY237

Action

- Le numéro de série va être actualisé dans Phonak Target
- Le numéro de série va être actualisé dans Phonak Target

Presser sur "Annuler" pour résoudre manuellement les conflits.

Buttons: Continuer, Annuler

Dans le cas où l'audioprothésiste a également modifié les paramètres d'appareillage, un message d'avertissement s'affiche. Vous pouvez résoudre le conflit en choisissant l'option désirée.

Veillez noter que les données ALPS sont les informations dernièrement mises à jour par le centre agréé Lyric qui a procédé au remplacement de l'appareil de votre client. Les données Phonak Target correspondent à vos propres données.

The screenshot shows a Lyric interface with a green header. Below the header is an orange bar with the title "Incompatibilité des paramètres d'appareillage!". The main content area displays the following information:

Les paramètres d'appareillage enregistrés dans ALPS et dans Phonak Target ne correspondent pas.

Droit Gauche

Résoudre le conflit:

- Utiliser les données de Phonak Target
Dernière mise à jour: 04.08.2014 15:26
- Utiliser les données ALPS (le plus récent)
Dernière mise à jour: 04.08.2014 15:58
Mise à jour par l'audioprothésiste vu en dépl.

Les paramètres d'appareillage sont identiques

Le conflit sera résolu en cliquant sur "Continuer".
Cliquez sur "Annuler" pour résoudre le conflit manuellement.




Buttons: Continuer, Annuler

Renouvellement automatique de la souscription

Deux mois avant la date d'expiration de la souscription, vous recevez un rappel dans Target/ALPS qui vous informera de la date du renouvellement automatique. Lorsque la date est atteinte, le renouvellement est alors effectué de façon automatique pour une année supplémentaire.


Au cas où cela ne serait pas souhaité par le client, vous disposez des choix suivants :

1. Renouveler la souscription de façon manuelle et choisir un autre type de paiement ou une autre durée de souscription (uniquement valable en France)
2. Annuler le renouvellement de la souscription.

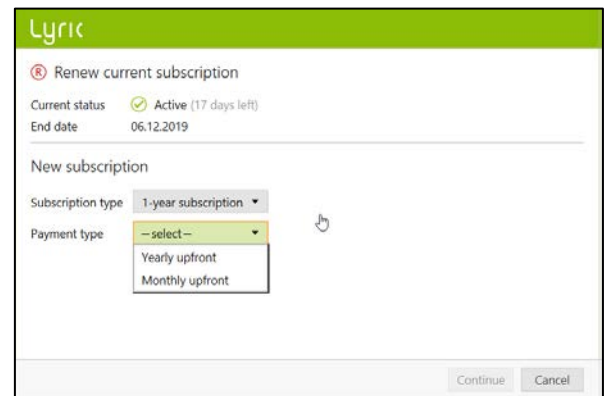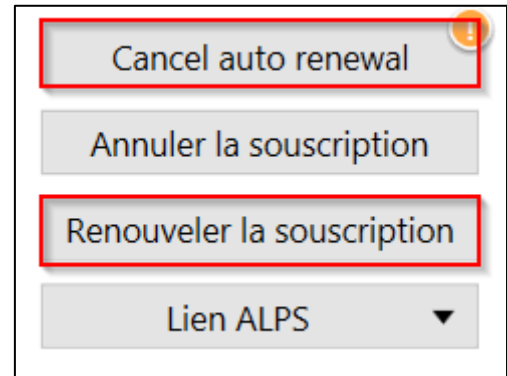

Au cas où le client ne souhaite pas renouveler sa souscription, il vous est demandé d'entrer la raison du non renouvellement lorsque vous annulez la souscription subséquente.

Une souscription renouvelée est active par défaut, sans période d'essai.

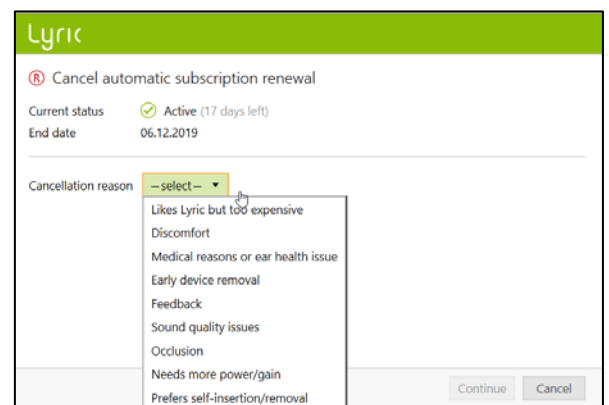


Annuler une souscription active

S'il était nécessaire d'annuler une souscription active (pour des raisons médicales), cliquez sur [Annuler la souscription] dans l'onglet [Configuration Lyric].

Pour confirmer la demande d'annulation, choisissez le motif d'annulation et cliquez sur [Continuer]. La demande d'annulation sera envoyée à votre service client Phonak.

Veillez noter que de nouvelles raisons d'annulation ont été ajoutées : [Patient décédé] et [Patient incommodé par les échanges].

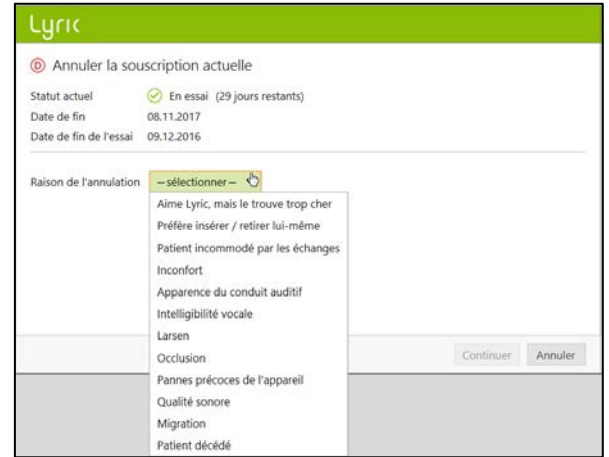

Synchroniser des modifications effectuées hors connexion

Il existe des situations (comme une absence de connexion internet temporaire ou un problème informatique), où vous devez travailler hors connexion. Cela signifie que les nouvelles données de Phonak Target ne sont pas synchronisées avec ALPS.


Le retrait d'un appareil Lyric hors connexion fonctionne de la même manière que le retrait du dispositif lorsque vous êtes connectés avec ALPS.

Vous êtes maintenant invité à [Insérer un nouvel appareil] Lyric. Entrez le numéro de série ainsi que le code visible sur l'emballage Lyric. Puis, entrez la profondeur d'insertion mesurée. Si nécessaire, les paramètres d'ajustement peuvent être changés.

The screenshot shows the 'Configuration Lyric' window with the title 'Retirer l'appareil Lyric'. The 'Numéro de série' is 1633H00L1. The 'Retiré par' field has radio buttons for 'Audioprothésiste' (selected) and 'Patient lui-même'. The 'Date du retrait' has radio buttons for 'Aujourd'hui' and 'Auparavant' (selected), with a date input field showing 10.11.2016. The 'Raison du retrait' is set to 'Inconfort'. There is a text input field for 'Détails supplémentaires (optionnel)...'. The 'Observation du conduit auditif' has a dropdown menu set to 'OK pour réinsertion immédiate' and a text input field for 'Observation supplémentaire du conduit auditif (optionnel)...'. At the bottom, a message states: 'Pas de connexion à ALPS. Toutes les modifications seront synchronisées ultérieurement.' Buttons for 'Enlever' and 'Annuler' are at the bottom right.


The screenshot shows the 'Configuration Lyric' window with the title 'Saisir les informations sur l'appareil'. The 'Numéro de série' is 1633H00KR. The 'Code' is E396. The 'Modèle' is Lyric3. The 'Taille de l'appareil' is XL. There is a mouse cursor over a small icon. At the bottom, a message states: 'Pas de connexion à ALPS. Toutes les modifications seront synchronisées ultérieurement.' Buttons for 'Sélectionner' and 'Annuler' are at the bottom right.

Dès que Phonak Target est reconnecté à ALPS, les réglages hors connexion sont automatiquement synchronisés dans ALPS.

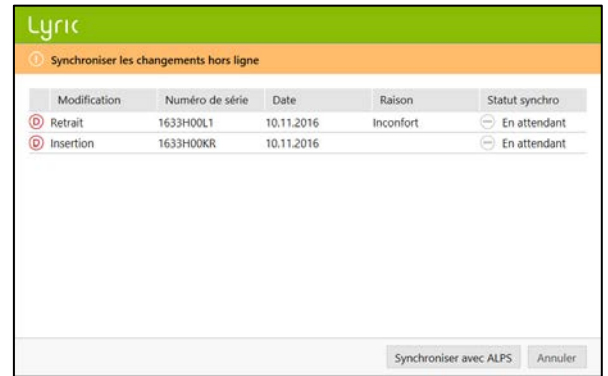

Vous êtes informés de la réussite de la synchronisation.

Après un réglage hors ligne, des fichiers log sont disponibles sur votre ordinateur.


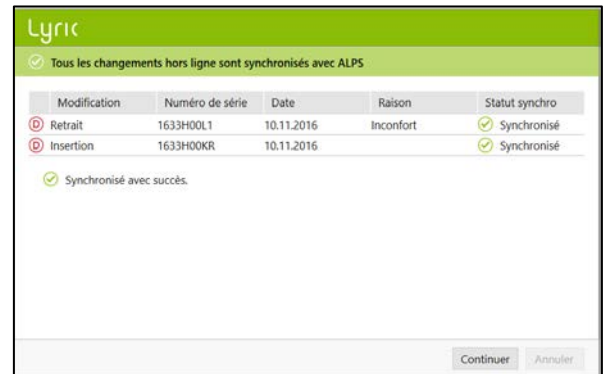


Trouver les raccourcis vers ALPS

Certaines actions doivent être réalisées dans ALPS :

- Ouvrez ALPS
- Afficher les détails sur le patient,
- Imprimer la carte d'identification Lyric,
- Accéder aux rapports

- Imprimer les rapports,
- Consulter l'historique des appareils
- Afficher les détails de l'appareillage




Dans ALPS, vous pouvez lire les informations suivantes sur l'écran d'accueil :

- Souscriptions incomplètes
- Souscriptions à expiration
- Essais
- Appareils à expiration
- Appareils dans l'oreille depuis plus de 120 jours



Dans la section [Essais] vous pouvez trier et rechercher dans les champs individuels. Cela permet d'en savoir plus sur la date de fin d'essai de votre patient.

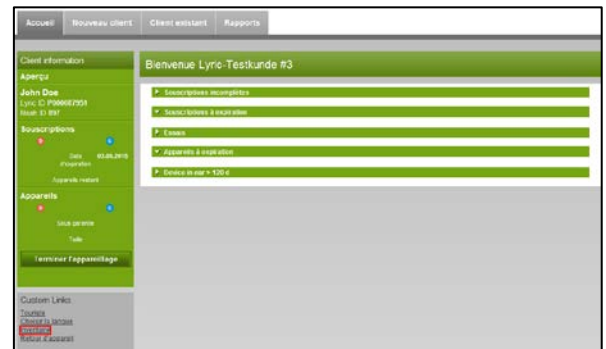


Pour vous inscrire à la notification automatique par courriel, allez dans [Notification par courriel] et entrer l'adresse e-mail. Vous pouvez également sélectionner l'information pour toutes vos succursales en cliquant sur [Notification pour toutes vos succursales]. Le courriel contient les informations :


- Essais à date d'expiration dans les 7 jours
- Souscriptions à renouveler




Une fois les clients contactés, leur nom peut être simplement éliminé de la liste en sélectionnant [Renouvelée] ou [Confirmé]. Cette liste est visible sous [Liste des patients contactés].

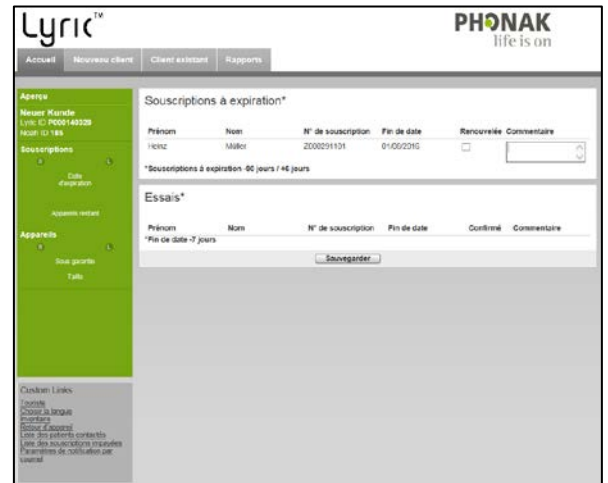


Dans la section [Inventaire] vous pouvez afficher ou imprimer votre stock consigné d'appareils Lyric.

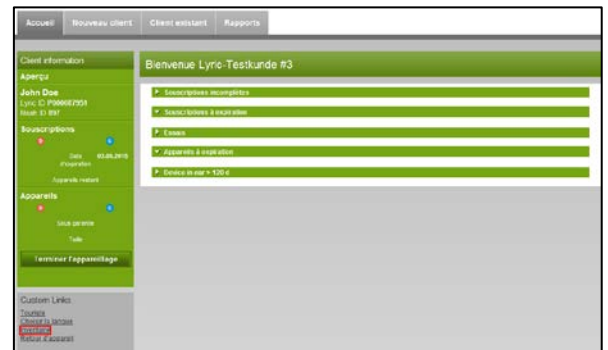


Si un appareil doit être renvoyé à Phonak via votre contact local Lyric, veuillez sélectionner [Retour d'appareil] et cliquer sur le numéro de série et le motif de retour correspondants.

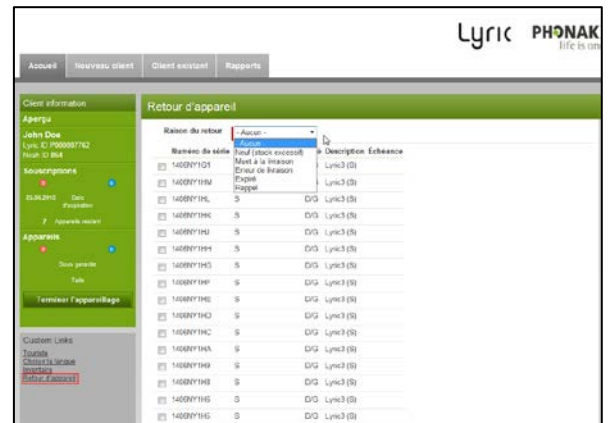

Dans l'onglet [Rapports], vous pouvez trouver tous les rapports nécessaires pour gérer les souscriptions et les appareils.

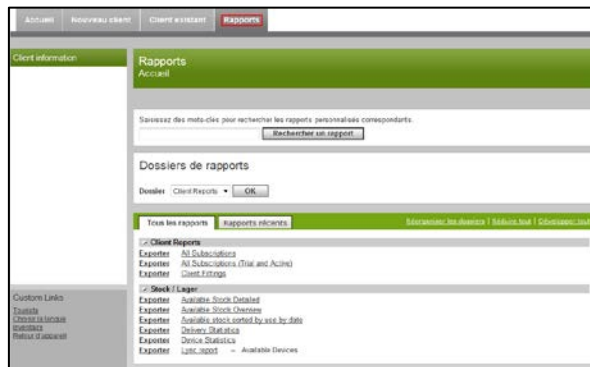


Ils peuvent être triés par date de début ou de fin et exportés dans Microsoft Excel afin d'être édités.



Activer l'historique détaillé pour l'assistance

Si vous rencontrez un problème avec Target, un enregistrement avancé des événements peut aider notre support Target à en déterminer la source.

Allez dans [Aide] & [Fichiers log] et choisissez la façon d'envoyer les informations à Phonak.

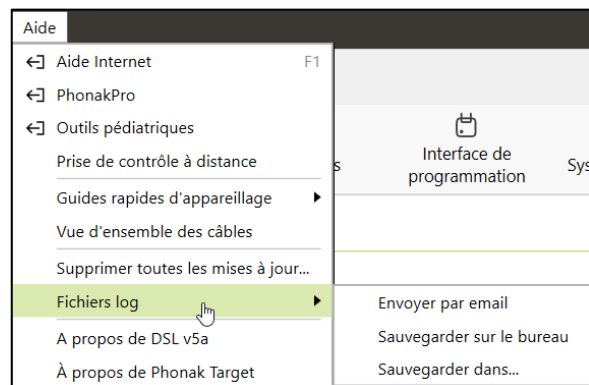

Information et description des symboles et de la configuration requise du système

Le « Phonak Target Fitting Guide » contient les informations et description des symboles et de la configuration requise du système.



2021-12-01

Sonova AG • Laubisrütistrasse 28 •
CH-8712 Stäfa • Switzerland



Sonova Deutschland GmbH
Max-Eyth-Str. 20
70736 Fellbach-Oeffingen • Germany



058-0125-072
Phonak Target 7.2 DVD



0459

CE mark applied 2021